

Sosnowiec, dn.27.02.2018r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę sterylnych jednorazowych obłożeń pól operacyjnych.**
Znak sprawy: **ZP-2200- 8/18**

Wyjaśnienia Zamawiającego 2

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 4

dotyczy PAKIETU NR 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z opisanym w SIWZ o gramaturze 75g/m² + łata chłonna o gramaturze 80g/m²?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zestaw.

Pytanie 5

dotyczy PAKIETU NR 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o gramaturze wyższej od opisanej w SIWZ, w składzie nieznacznie różniącym się od opisanego w SIWZ?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

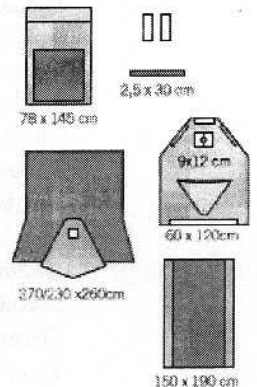

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 47

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z serwetą do cesarskiego cięcia w następującym składzie:

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny, wyposażona w sztywnik do modelowania brzegów. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany zestaw

Pytanie 48

Pakiet 5 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami chirurgicznymi ze wzmocnieniami nieprzemakalnymi w przedniej części fartucha i na rękawach do łokcia zapewniającymi barierę w części krytycznej?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany zestaw z fartuchami

Pytanie 53

Pakiet 1 pozycja 1



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

ww.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
YDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
ĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

72 847 000, 00

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną o wymiarach 45x45 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną serwetę

Pytanie 54

Pakiet 1 pozycja 2 i 6, pakiet 2 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze min.40g/m², spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013.

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H₂O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m² wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta.

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze min. 40 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną serwetę

Pytanie 55

Pakiet 1 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną serwetę

Pytanie 56

Pakiet 1 pozycja 11

Czy Zamawiający, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 11 do osobnego zadania?

Odpowiedź: pozostawiona bez odpowiedzi z uwagi na odpowiedź na pytanie 55

Pytanie 57

Pakiet 3 pozycja 2-4

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu posiadania przez folię fingerliftów odrywanych po przyklejeniu i dopuści system zabezpieczeń papierowych nieodrywalnych ułatwiających aplikację?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 58

Pakiet 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG:

* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torbka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną osłonę

Pytanie 59

Pakiet 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²



4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m ²
10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką
20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm
1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m ² , wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L
3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m ² , wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 60

Pakiet 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
3 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m ²
1 x podład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm
1 x fartuch foliowy przedni o wymiarach 80 cm x 130 cm
2 x zaciskacz do pepowiny
10 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm

Z osobno sterylnie zapakowanymi fartuchami wykonanymi z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² ze wzmocnieniem nieprzemakalnymi o gramaturze 38g/m² w przedniej części fartucha do długości ok. 25cm od dolnej krawędzi i na rękawach do łokcia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 61

Pakiet 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² , zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m ²
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany zestaw

Pytanie 62

Pakiet 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m² w strefie krytycznej wyposażonymi we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²? Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 152 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany zestaw

Pytanie 63

Pakiet 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² .
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m ²
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany zestaw

Pytanie 64

Pakiet 10 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² , zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m ²
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Z osobno dołączoną sterylnie zapakowaną osłoną na kończyne w rozmiarze 30x80cm lub w rozmiarze 35x120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany zestaw z osłoną na kończyne w rozmiarze 35x120cm

Pytanie 65

Pakiet 10 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z trzema taśmami samoprzylepnymi zamiast dwóch taśm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany zestaw

Pytanie 66

Pakiet 10 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany zestaw

Pytanie 67

Pakiet 10 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyne, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gram. 50 g/m ² .
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany zestaw

Pytanie 68

Pakiet 10 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówkę odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² oraz dolna część serwety wykonana z folii PE.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany zestaw

Pytanie 69

Pakiet 10 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z jedną taśmą przylepną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną osłonę

Pytanie 70

Pakiet 10 pozycja 7

Czy Zamawiający, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, dopuści dołączenie drugiej taśmy osobno sterylnie zapakowanej?

Odpowiedź: pozostawiono bez odpowiedzi z uwagi na odpowiedź na pytanie 69

Pytanie 71

Pakiet 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniami nieprzemakalnymi w przedniej części fartucha do długości ok. 25cm od dolnej krawędzi i na rękawach do łokcia o gramaturze min. 38g/m², spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany fartuch

Pytanie 73

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakietu nr 1 pozycja nr pozycja 11** Serwety sterylnej na stolik Mayo o wymiarach min. 78 x min 140cm, z mocnej folii o grubości min 0,07 mm, pokrytej włókniną o gramaturze min. 36g/m², złożona z dużym wywinięciem co ułatwia nakrycie stolika lub złożona teleskopowo. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 74

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakietu nr 5, pozycja 1** serwetę min. 180 x min. 300cm z otworem o wymiarach min. 25 x min. 30 cm, wypełnionym folią chirurgiczną zintegrowaną z workiem do przechwytywania płynów, wyposażona w sztywnik do modelowania

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 75

Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakietu nr 5, pozycja 2** serwetę na stół narzędziowy min.90 x min.120cm,

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 76

Pytanie nr 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakietu nr 2**, Serwetę sterylną o wymiarach min. 50cm x 70 cm z otworem 5-6 cm x 5-6 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną serwetę

Pytanie 77

Pytanie nr 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakietu nr 6, pozycja 1** serwetę do zabiegów ginekologicznych o wymiarach min. 180cm x min. 245cm z otworem na krocze o średnicy 12 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną serwetę

Pytanie 78

Pytanie nr 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 10, pozycja 2** serwetę chirurgiczna o wym. min 200 x min 300cm wyposażona w elastyczny, samouszczelniający otwór o średnicy min. 3,5 cm, otoczonym warstwą chłonną o wymiarze min. 70 x 70 cm, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze min. 50g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną serwetę

Pytanie 79

Pytanie nr 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 10, pozycja 4** serweta chirurgiczna dolna o wymiarach min.150 x min 230cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach min. 8 x 80 cm z taśmą samoprzylepną

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną serwetę

Pytanie 80

Pytanie nr 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 10, pozycja 5** serwetę chirurgiczna do operacji brzuszno-kroczywych o wymiarach min. 230 x min. 250cm z otworem w okolicy jamy brzusznej o wymiarach, min. 30cm x min. 30cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz samoprzylepny eliptyczny otwór o śr. 12 cm osłonięty klapką - serweta zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezyjologicznym

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną serwetę

Pytanie 81

Pytanie nr 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 12** fartuch chirurgiczny pakowany bez ręczników lub ręczniki dodawane osobno

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

E. Kwaśnicka
KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PIURTYCZNYCH
E. Kwaśnicka
mgr Ela Kwaśnicka

