

Weihai Hongyu Medical Devices Co., LTD

Declaration

Manufacturer: Weihai Hongyu Medical Devices Co., LTD.
NO.86 Shenzhen Road, Weihai City, 264205, P.R. China

EU representative:

Weikang Tech Consulting
Suite B, 29 Harley Street, LONDON W1G 9QR, United Kingdom

Medical Devices:

Product Name: Disposable blood collection needles,
Luer adapter
Holder

We declare that, our above mentioned products fit and can be used to cooperation with vacuum tubes of blood collection systems:

Name
VACUTAINER
VACUTEST
VACUETTE
VENOJECT
MLVACUCOL


Manufacturer
BECTON DICKINSON
KIMA
GREINER BIO ONE
TERUMO
MEDLAB PRODUCTS



[Handwritten signature]

(General Manager)

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd



tłumaczenie w/wierzone w białe z języka angielskiego na język polski

Weihai Hongyu Medical Devices Co., LTD

Deklaracja

Producent: WYROBY MEDYCZNE WEIHAI HONGYU CO., LTD.
No. 83 Shenzhen Road, Weihai City, 264205, Chińska Republika Ludowa

Przedstawiciel w UE:

Weikang Tech Consulting
Suite B, 29 Harley Street, LONDYN W1G 9QR, Zjednoczone Królestwo

Wyroby medyczne:

Nazwa produktu: igły do pobierania krwi jednorazowego użyciu
adapter Luer
uchwyty

Oświadczamy, że wymienione wyżej produkty są odpowiednio do łączenia i stosowania z próbkami próżniowymi do pobierania krwi następujących producentów:

Nazwa:
VACUTAINER
VACUTEST
VACUETTE
VENOJECT
MLVACUCOL

Producent:
BECTON DICKINSON
KIMA
GREINER BIO ONE
TERUMO
MEDLAB PRODUCTS

nieczytelny podpis/

(dyrektor generalny)

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Ltd

/owalna pieczęć w języku obcym oraz następującym napisem w otoku/
WEIHAI HONGYU MEDICAL DEVICES CO., LTD

/pieczęćka w języku polskim/

Jin Dajunara Broj, tłumacz przysięgły /języka angielskiego (TP/3451/05) zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z kopią do kumenu w języku angielskim.


Łódź, dnia 08.02.2012

Liczba stron: 2

Reperitorium numer 69/02/TP/2012

"TRADO"

www.trado.pl trado@trado.pl
90-125 Łódź, ul. Narutowicza 31 lok. 24
tel./faks (042) 636-33-50, 636-36-93
NIP: 727420-3370, REGON 147171808



Załącznik 4

02 GRU. 2015

Za zgodność z oryginałem


PREZES ZARZADU

[Handwritten signature]
Andrzej Cudowski




SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŻNY
w Warszawie

ZPO



Warszawa, dnia 23.07.2013 r.

DZP/196/07/2013



MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o. o.
ul. Gałczyńskiego 8
05-090 Raszyn

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo nr MLP/2506/13 z dnia 12.07.2013r. informuję, iż próbówki do podciśnieniowego pobierania krwi MLVacuCol produkowane przez Medlab Products Sp. z o.o., dostarczane do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie w ramach umowy przetargowej PN/27SML/09/2012, mogą być stosowane z akcesoriami do pobierania krwi innego producenta.

Z poważaniem,

DYREKTOR SZPITALA

Agnieszka Kijawska-Misiąg

02 GRU. 2016

Za zgodność
z oryginałem

PREZES ZARZADU


Adam J. Godlewski



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŻNY

W WARSZAWIE

REFERENCJE



W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr znak: PN/27SMI./09/2012 z dnia 15.11.2012 r. Szpital zawarł umowę ze Spółką Medlab-Products Sp. z o.o. na dostawę probówek do podciśnieniowego pobierania krwi ML.VacuCol™.

Umowa Nr PN/27DML/09/2012/G obowiązuje od 08.01.2013r. do 14.08.2014r. Przez 14 miesięcy trwania umowy Szpital dokonał zakupów probówek ML.VacuCol™ w ilości ok. 250 000 szt.

Dostarczane przez Medlab-Products Sp. z o. o. probówki MLVacuCol™ spełniają w pełni nasze wymagania i współpracują bezproblemowo zarówno z akcesoriami do pobierania krwi używanymi przez Szpital jak i analizatorami używanymi do badania krwi.

Firma Medlab-Products Sp. z o.o. nasze zamówienia realizuje z należytą starannością produktami wysokiej jakości, dlatego też możemy ją polecić jako solidnego i rzetelnego wykonawcę.

02 GRU. 2016

Za zgodność
z oryginałem


PREZES ZARZĄDU

Warszawa, marzec 2014

Załącznik 7

SZPZOZ OLEŚNICA
PRZYCHODNIA REJONOWA
Centralne Laboratorium Analityczne
56-400 OLEŚNICA, ul. Gen. J. Hallera 25

Oleśnica 15.10.2013r



MEDLAB-PRODUCTS
ul. Gątczyńskiego 8
05-090 Raszyn

Centralne Laboratorium Analityczne SZPZOZ w Oleśnicy od ponad roku pracuje systemem zamkniętym MLVacuCol z akcesoriami firmy Hongyu Medical. System ten w pełni zaspakaja nasze oczekiwania. Łatwość pobierania i przebijania korków, dokładność pobranej krwi są głównym atrybutem dla którego pracownicy Laboratorium preferują ten system. Probówki MLVacuCol są również kompatybilne z akcesoriami innych firm.

KATARZYNA
CENTRALNE LABORATORIUM
ANALITYCZNE
Katarzyna
mgr farm. Iwona Hejnik
specjalista analityki laboratoryjnej

02 GRU. 2015

Za zgodności
z oryginałem

PREZES ZARZADU

Adrian G. Czaplinski

LABORATORIUM 8

Data 12.09.2015

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
72-300 Gryfice, ul. Niechorńska 27
tel. 91 384 21 00, tel. centr. 91 384 20 61
NIP 657-16-88-560, R. 000310204
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
(68)

.....
Pieczętka firmowa

Referencja

Oświadczamy, że od momentu wprowadzenia na rynek probówek do podciśnieniowego pobierania krwi MLVacuCol™, których wytwórcą jest firma Medlab Products Sp. z o.o, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach jest ich użytkownikiem. W tym czasie wykonaliśmy ponad tysiące pobrań krwi z wykorzystaniem probówek MLVacuCol™. Do pobrań tych używaliśmy akcesorii (igieł, uchwyty, adapterów, wkłuc motylkowych) pochodzących od różnych systemów używanych w tym okresie w naszym Szpitalu tj.:

- VACUETTE firmy Greiner-bio-One
- VACUTAINER firmy Becton Dickinson
- VACUTEST firmy KIMA
- akcesoria firmy Hongyu Medical.

Na bazie naszych doświadczeń, stwierdzamy, że probówki MLVacuCol™ są kompatybilne z akcesoriami do pobierania krwi wyżej wskazanych wytwórców i współpracują z nimi prawidłowo i bez zastrzeżeń.

KIEROWNIKI ZAKŁADU
DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

mgr Krzysztof Aniko
SPECJALISTA ANALIZY KLINICZNEJ

.....
Podpis i pieczętka Kierownika Jednostki

02 GRU. 2015

Za zgodność
z oryginałem
PREZES ZARZĄDU

Adam Godlewski

ZALĄCZNIK 9




CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W WARSZAWIE

02-507 Warszawa ul. Wołoska 137

Dyrektor tel. /22/ 508 10 20
Z – cy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. /22/ 508 10 24
Z – ca Dyrektora ds. Marketingu i Administracji tel. /22/ 508 18 13

Fax /22/ 845 14 68

L. dz.



Warszawa, dn. 29.08.2013 roku

Medlab – Products Sp. z o. o.
ul. Gałczyńskiego 8
05-090 Raszyn

OPINIA

Dotyczy: probówkach podciśnieniowych (próżniowych) systemu MLVacuCol™, którego wytwórcą jest firma Medlab – Products Sp. z o. o.

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie informuje, że przeprowadzone w lipcu 2013 roku w trzech klinikach sprawdzono prawidłowości działania probówek podciśnieniowych (próżniowych) systemu MLVacuCol™, w zakresie ilości pobieranej krwi, łatwości napełniania, prawidłowości przygotowania krwi w probówkach, poprawności uzyskiwanych wyników oraz prawidłowości współpracy tych probówek z akcesoriami do pobierania krwi w systemach podciśnieniowych (igły, uchwyty, adaptery, wkłucia motylkowe)

Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzamy, że probówki MLVacuCol™ firmy Medlab – Products Sp. z o. o. działają prawidłowo .

Za zgodność
z oryginałem

oprac.: RP/UKK PREZES ZMZRZADU

Adam J. Godlewski
Adam J. Godlewski

Centralny Szpital Kliniczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie
ul. Wołoska 137, Warszawa 02-507


DYREKTOR
Centralnego Szpitala Klinicznego MSW
w Warszawie

dr hab. n. med. Marek Durlik
dr hab. n. med. Marek Durlik
Profesor Polskiej Akademii Nauk

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000133822, REGON 006472651, NIP 521-29-25-596

217613/CLM/K 10

PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE
w Pleszewie Sp. z o.o.
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125B
tel. (0-62) 74 20 700; fax 74 20 803
NIP 6090074569 Regon 300770003



ZAŚWIADCZENIE

Dotyczy: JAKOŚCI SYSTEMU PODCIŚNIENIOWEGO POBIERANIA KRWI DO BADAŃ FIRMY MEDLAB - PRODUCTS

W nawiązaniu do pisma firmy Medlab – Products Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie z dnia 20 października 2016 roku, oświadczamy, że firma ta dostarcza do Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. system do podciśnieniowego pobierania krwi do badań od początku 2014 roku w ramach kolejnych postępowań przetargowych. Do dzisiaj zużyliśmy ponad 500 000 sztuk jednostek. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego zaświadczenia, oświadczamy, iż dotychczas nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu dostarczanych próbek o nazwie handlowej MLVacucol wraz z akcesoriami produkowanymi przez firmę Hongyu Medical Ltd, które przez Wykonawcę są sprzedawane jako igły dedykowane do współpracy z systemem MLVacucol. Jakość całego systemu oceniamy wysoko i spełnia on nasze oczekiwania.

WICEPREZES ZARZĄDU
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

[Signature]
Błażej Gorczyński

Pleszew 21.10.2016 r.

02 GRU. 2016

Za zgodność
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
Adam J. Godlewski

214EAC2MK 11




**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Świdnicy**

58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29, e-mail: spzoz@szpital.swidnica.pl
Dyrekcja - Sekretariat tel. (74) 85 17 400, fax. (74) 85 17 437, centrala (74) 85 17 100



NP.: 070.2016



Świdnica, dnia 24.10.2016r.

MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.

**ul. Gałczyńskiego 8
05-090 Raszyn**

**Opinia o kompatybilności elementów systemu zamkniętego
dostarczanych przez firmę Medlab-Products sp z o. o.
pochodzących od różnych producentów**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.10.2016 roku oświadczamy, że dostarczane nam od 2014 roku w ramach umów zawartych w trybie zamówień publicznych, elementy systemu podciśnieniowego pobierania krwi do badań o nazwie VacuCol oraz akcesoria do pobierania krwi firmy Hongyu Medical Ltd i innych wytwórców, są ze sobą w pełni kompatybilne i gwarantują we współpracy ze sobą wysoką jakość pobierania i badania krwi. Jakość dostarczanych nam próbek VacuCol, jak i akcesoriów do pobierania do nich krwi takich jak: igły, uchwyty itp. jest bardzo dobra i z pewnością nie gorsza niż takich samych produktów innych dostawców.

Jesteśmy użytkownikiem tego systemu podciśnieniowego od początku 2014 roku i nasza opinia została wystawiona na bazie doświadczenia jakie daje nam zużycie w tym czasie prawie 800 tysięcy sztuk jednostek tego systemu. W powyższym okresie nie zanotowaliśmy skarg użytkowników elementów systemu z tytułu wad lub braku kompatybilności.

Za zgodność
z oryginałem

02 GRU. 2016

PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR

Adam Podgórski

Grzegorz Kłoc



L19632MK 12

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ADAMA GRUCY
05-400 Otwock ul. Konarskiego 13

Sekretariat Dyrektora Naczelnego: tel. 22 779 32 02 fax 22 779 35 71

Sekretariat Dyrektora Opieki Medycznej/Dyrektora Technicznego: tel. 22 779 28 15

Centrala: tel. 22 779 40 31

Otwock, dnia 28 października 2016 roku

Medlab Products Sp. z o.o.
Ul. Gałczyńskiego 8
05-090 RASZYN

OPINIA

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku na wniosek Wykonawcy – firmy Medlab – Products sp. z o. o. wydaje pozytywną opinię o dostarczonym przez tę firmę od czerwca 2015 roku, systemie podciśnieniowym pobierania krwi do badań.

Uważamy, że próbówki do pobierania i badania krwi systemu MLVacuCol są bardzo dobrej jakości i w pełni kompatybilne z dostarczonymi przez Wykonawcę akcesoriami produkcji Hongyu Medical. Personel pobierający krew w klinikach oraz oddziałach naszego szpitala nie zgłasza żadnych uwag do jakości współpracy próbek, igieł i uchwytów, co więcej nie zwraca uwagi na producenta poszczególnych elementów przy wykonywaniu pobrania, gdyż dostarczane przez firmę Medlab – Products próbówki oraz akcesoria do nich nie tylko współpracują poprawnie ze sobą, ale też są kompatybilne z wcześniej używanym w szpitalu systemem podciśnieniowym firmy Vacuette.

W naszej ocenie, po ponad rocznej pracy przy użyciu systemu podciśnieniowy pobierania krwi do badań dostarczanego w ramach umowy przetargowej przez firmę Medlab – Products, wszystkie dostarczane elementy systemu są wysokiej jakości, dobrze oceniane przez personel pobierający krew oraz laboratorium w zakresie wiarygodności otrzymywanych wyników.

DYREKTOR NACZELNY
S.P. Szpitala Klinicznego
im. prof. A. Grucy w Otwocku

02 GRU. 2015

Dr n. med. Mieczysław Błaszczak

www.spskgruca.pl e-mail: sekretariat@spskgruca.pl

NIP: 532-16-62-948 REGON: 000290156

Za zgodność
PREZES ZARZĄDU
z oryginałem
Adam J. Górczewski



Krew żylna

Igły

PRODUKTY BEZPIECZNE



Bezpieczna igła BD Vacutainer® Eclipse™

- Sterylna, jednorazowego użytku
- Bezpieczna igła do pobrania wielu próbek krwi
- Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym/transportowym: 48/480

	Nr kat.	Rozmiar Gauge	Długość	Kolor
	368609	21G (0.8mm)	1.25" (32mm)	Zielony
	368610	22G (0.7mm)	1.25" (32mm)	Czarny

Bezpieczna igła BD Vacutainer® Eclipse™ z uchwytem


- Sterylna, jednorazowego użytku
- Bezpieczna igła do pobrania wielu próbek krwi z fabrycznie zamocowanym uchwytem
- Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

	Nr kat.	Rozmiar Gauge	Długość	Akcesoria	Kolor
	368650	21G (0.8mm)	1.25" (32mm)	przyłączony uchwyt	Zielony
	368651	22G (0.7mm)	1.25" (32mm)	przyłączony uchwyt	Czarny

02 GRU. 2016

Za zgodność
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

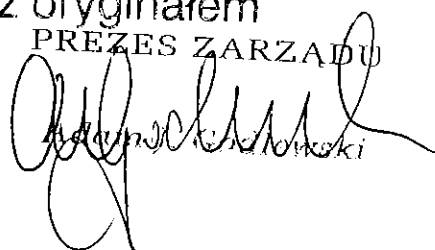


Andrzej Krawczuk

AKCESORIA




Uchwyt BD Vacutainer® jednorazowego użytku

- Jednorazowego użytku
- Kompatybilny z probówkami i igłami BD Vacutainer® oraz z butelkami do posiewów krwi BD Bactec™
- Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym/transportowym: 250/1000

	Nr kat.	Opis	Kolor
	364815	Uchwyt jednorazowego użytku	Biały

Adaptory BD Vacutainer®

- Jednorazowego użytku
- Zamknięty system zapewniający mniejsze ryzyko zakażeń związanych z przenoszeniem krwi
- Kompatybilny ze wszystkimi probówkami i igłami BD Vacutainer®

	Nr kat.	Opis	Kolor	Opakowanie zbiorcze/transportowe szt.
	367300	Adapter Luer do pobierania krwi z cewników lub do stosowania w połączeniu z kaniulami typu Luer	Ciemnoniebieski	100/1000
	364902	Urządzenie dostępowe BD Vacutainer® Luer-Lok™	Przezroczysty	50/200
	364810	Adapter BD Vacutainer® do przenoszenia krwi	Przezroczysty	50/200

02 GRU. 2015

Za zgodność
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

