



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.



**SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.**

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
'DZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
DOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

72 847 000, 00

Sosnowiec, dn.17.10.2018r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę sprzętu na blok operacyjny**
Znak sprawy **ZP-2200-49/18**

Wyjaśnienia Zamawiającego 3

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Dot. Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l – poz. 4
Zdjęcie produktu, którego dotyczą pytania:



PYTANIE NR 1:

Czy zamawiający zamierza ogrzewać w urządzeniu płyny infuzyjne lub inne płyny będące wyrobami medycznymi?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający będzie ogrzewał różnego rodzaju płyny używane w szpitalu.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym, czy laboratoryjnym,
co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586), a producent posiada wdrożony system jakości ISO 13 485 niezbędny dla producentów sprzętu medycznego? Potwierdzeniem medycznego statusu urządzenia jest stawka podatku VAT 8%.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zarówno cieplarkę medyczną jak i laboratoryjną.

PYTANIE NR 3: Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l – poz.4 punkt 7 specyfikacji technicznej

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cieplarkę medyczną z większym niż wymagany zakresem pracy temperatur między 25°C - 70°C ±1°C (zmiana o 1°C)? Oczywiście urządzenie będzie można zaprogramować przez użytkownika do osiągnięcia maksymalnej temperatury 42°C, ale jeśli zajdzie taka potrzeba przyszły użytkownik będzie mógł ustawić temperaturę w zakresie 25°C - 70°C. Większy zakres pracy to większe możliwości i dodatkowy atut, który jest zaletą takiego urządzenia jak Ciepłarka Medyczna.

ODPOWIEDŹ:

Tak, dopuszcza. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 4: Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l – poz.4 punkty 9-10 specyfikacji technicznej

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną, której zewnętrzne wymiary urządzenia wynoszą: 740 x 1740 x 790 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość), natomiast wewnętrzny wymiar komory: 572 x 1371 x 529.5 mm (S x W x G)? Taki czynnik jak wymiar nie powinien być czynnikiem eliminującym konkurencję z postępowań przetargowych. Każdy producent produkuje urządzenia o innych wymiarach, dlatego też wskazanie konkretnych wymiarów może wskazywać jednoznacznie na jednego producenta. Taki parametr uniemożliwia szpitalowi osiągnięcia celu postępowań przetargowych, czyli zakupu sprzętu na jak najlepszych warunkach.

ODPOWIEDŹ:

Tak, dopuszcza taki wymiar cieplarki.

PYTANIE NR 5: Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l – poz.4 punkty 11; 12; 13 specyfikacji technicznej

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną posiadającą trzy niezależne zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz spełniającą wszystkie normy bezpieczeństwa wymagane dla tego rodzaju sprzętu medycznego, wyprodukowanej według normy ISO 13485 wymaganej dla producentów sprzętu medycznego? Dwa zabezpieczenia elektroniczne i jedno zabezpieczenia mechaniczne oraz norma jakości ISO 13 485 dają pewność zamawiającemu, że sprzęt spełnia wszystkie niezbędne normy bezpieczeństwa. Cieplarka oczywiście posiada wizualny jak i dźwiękowy alarm zbyt wysokiej jak również z zbyt niskiej temperatury.

ODPOWIEDŹ:

Tak, dopuszcza. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 6: Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l – poz.4 punkty 18 specyfikacji technicznej


Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cieplarkę medyczną nie posiadającą zamknięcia drzwi komory na kluczyk? Wymóg ten jest zbędny w praktycznym użytkowaniu cieplarki medycznej i ogrzewaniu w jej wnętrzu płynów infuzyjnych. Płyny infuzyjne czy irygacyjne przechowywane są w szafkach bez zamknięcia więc wymóg zamykania ich w cieplarce wydaje się bezzasadny. Zamknięcie na klucz może również prowadzić do braku możliwości dostania się do płynów, jeśli ktoś z personelu nie odłoży klucza na miejsce i przypadkowo zabierze go ze sobą lub zgubi.

ODPOWIEDŹ:

Tak, dopuszcza. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Dot. Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 150 l – poz. 5

Zdjęcie produktu, którego dotyczą pytania:

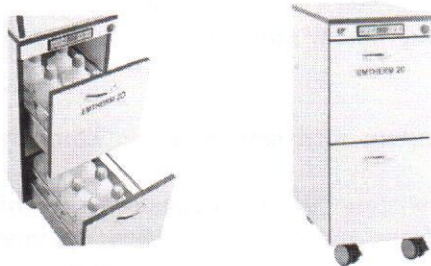

Uwaga: Z uwagi na rozbieżności w treści pytań (w nagłówku cieplarka 150L, natomiast w treści poszczególnych pytań cieplarka 300L) Zamawiający odniósł się w odpowiedziach do obu cieplarek.

PYTANIE NR 1:

Czy zamawiający zamierza ogrzewać w urządzeniu płyny infuzyjne lub inne płyny będące wyrobami medycznymi?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający będzie ogrzewał różnego rodzaju płyny używane w szpitalu.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym, czy laboratoryjnym, co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów

odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586), a producent posiada wdrożony system jakości ISO 13 485 niezbędny dla producentów sprzętu medycznego? Potwierdzeniem medycznego statusu urządzenia jest stawka podatku VAT 8%.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zarówno cieplarkę medyczną jak i laboratoryjną.

PYTANIE NR 3: Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l – poz.5 punkt 2 i 15 specyfikacji technicznej

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną o pojemności wnętrza komory około 88l składającej się z dwóch szuflad zamiast drucianych półek? Pojemność wnętrza komory nie ma tak dużego znaczenia jak ilość płynów jakie możemy umieścić w jednej szufladzie lub na jednej półce. Zakładając, że większość półek lub szuflad posiada maksymalne obciążenie 25 kg dopuszczenie cieplarki medycznej o mniejszej pojemności komory a mogącej pomieścić taką samą lub zbliżoną ilość płynów jest dla zamawiającego rozwiązaniem korzystniejszym.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.(Zarówno dla cieplarki 300L jak i 150L).

PYTANIE NR 4: Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l – poz.5 punkt 5 specyfikacji technicznej

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cieplarkę medyczną której obudowa wykonana jest w z płyt izolacyjnych posiadających bardzo dobre właściwości termoizolacyjne? Płyty izolacyjne posiadają bardzo dobre właściwości zatrzymywania ciepła wewnątrz komory i nienagrzewania się zewnętrznych części obudowy. Zastosowanie płyt izolacyjnych oprócz posiada również drugą zaletę jaką jest zmniejszenie rozmiarów i wagi urządzenia.

ODPOWIEDŹ:

Tak, dopuszcza. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.(Zarówno dla cieplarki 300L jak i 150L).

PYTANIE NR 5: Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l – poz.5 punkt 7 specyfikacji technicznej

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cieplarkę medyczną z większym niż wymagany zakresem pracy temperatur między 25°C - 42°C ±1°C (zmiana o 1°C)? Bardzo często jedną z wytycznych znajdujących się na opakowaniach płynów infuzyjnych jest zalecenie przechowywania ich w temperaturze 25°C. Dzięki zwiększonemu zakresowi temperatury zamawiający będzie miał możliwość zarówno przechowywania jak i ogrzewania płynów we wnętrzu komory.

ODPOWIEDŹ:

Tak, dopuszcza. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.(Zarówno dla cieplarki 300L jak i 150L).

PYTANIE NR 6: Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l – poz.5 punkt 9 i 10 specyfikacji technicznej

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną, której zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 823 x 620 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość), natomiast Wewnętrzny wymiar komory: 316 x 640 x 440 mm (S x W x G)? Mniejsze rozmiary urządzenia z zachowaniem zbliżonej ilości płynów jakie jesteśmy w stanie przechować w jej wnętrzu są dużą zaletą urządzenia i nie powinny stanowić przeszkody dla użytkownika.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.(Zarówno dla cieplarki 300L jak i 150L).

PYTANIE NR 7: Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l – poz.5 punkt 11; 12; 13 specyfikacji technicznej

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną posiadającą trzy niezależne zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz spełniającą wszystkie normy bezpieczeństwa wymagane dla tego rodzaju sprzętu medycznego, wyprodukowanej według normy ISO 13485 wymaganej dla producentów sprzętu medycznego? Dwa zabezpieczenia elektroniczne i jedno zabezpieczenia mechaniczne oraz norma jakości ISO 13 485 dają pewność zamawiającemu, że sprzęt spełnia wszystkie niezbędne normy bezpieczeństwa. Cieplarka oczywiście posiada wizualny jak i dźwiękowy alarm zbyt wysokiej jak również z byt niskiej temperatury.

ODPOWIEDŹ:

Tak, dopuszcza. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.(Zarówno dla cieplarki 300L jak i 150L).

PYTANIE NR 8: Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l – poz.5 punkt 14 i 17 i 16 specyfikacji technicznej

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cieplarkę medyczną którą otwieramy poprzez wysunięcie jednej z dwóch szuflad oraz nie posiadającej szybu w szufladach? Ze względu na brak szybu która przy zastosowaniu szuflad jest elementem zbędnym w urządzeniu nie zastosowano również oświetlenia wnętrza komory. Po odsunięciu szuflady widoczność jej zawartości jest tak dobra, że stosowanie dodatkowego oświetlenia nie jest konieczne.

ODPOWIEDŹ:

Dla cieplarki 300L – Zamawiający nie dopuszcza.

Dla cieplarki 150L – Zamawiający dopuszcza. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 9: Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 I – poz.5 punkt 18 specyfikacji technicznej

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cieplarkę medyczną nie posiadającą zamknięcia drzwi komory na kluczyk? Wymóg ten jest zbędny w praktycznym użytkowaniu cieplarki medycznej i ogrzewaniu w jej wnętrzu płynów infuzyjnych. Płyny infuzyjne czy irygacyjne przechowywane są w szafkach bez zamknięcia więc wymóg zamykania ich w cieplarce wydaje się bezzasadny. Zamknięcie na klucz może również prowadzić do braku możliwości dostania się do płynów, jeśli ktoś z personelu nie odłoży klucza na miejsce i przypadkowo zabierze go ze sobą lub zgubi.

ODPOWIEDŹ:

Tak, dopuszcza. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.(Zarówno dla cieplarki 300L jak i 150L).

DYREKTOR
DS. FINANSOWYCH I EKONOMICZNYCH
CZĘŚĆ I. Zarządu

mgr Robert Medrala