

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI
sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 03.03.2015r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek szpitalnych i mebli medycznych.

Znak sprawy ZP-2200-12/15

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

PYTANIA DO PAKIETU NR 1

Łóżko szpitalne dedykowane na oddział psychiatryczny – 15 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko o długości całkowitej 2150 mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca do łóżka bez opinii laboratoryjnej potwierdzającej właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o długości całkowitej równej 2230 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o szerokości całkowitej równej 1040 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o wymiarach leża (materaca): 2000 mm x 840 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy 125mm, nieantystatyczne, 2 koła posiadają indywidualną blokadę ruchu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o dopuszczalnym obciążeniu równym 170kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z pokrowcami materacy, które zamiast opinii laboratoryjnej potwierdzającej właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot posiadają certyfikat o nieprzenikaniu roztoczy oraz właściwościach antybakteryjnych wydany przez producenta tkaniny, z której produkowane są pokrowce do proponowanych materacy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z możliwością montowania uchwytu ręki na ramie szczytu od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści łóżka o szerokości leża 860mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżka o szerokości leża 860mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (15 szt.) z regulacją oparcia pleców dokonywaną za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego szerokość leża wynosi 860mm, co jest parametrem odbiegającym zaledwie o 10mm od dopuszczonej tolerancji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne, którego szerokość leża wynosi 860mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego konstrukcja jest połączona na stałe ze szczytami, które wykonane są z wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne jednolitego odlewu tworzywowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym regulacja segmentu pleców wspomagana jest sprężyną gazową, co jest rozwiązaniem korzystniejszym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z dopuszczalnym obciążeniem 170 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego rama łóżka lakierowana jest proszkowo w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne, którego rama łóżka lakierowana jest proszkowo w kolorze białym. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Szafki przyłóżkowe dedykowane na oddział psychiatryczny – 15 sztuk.**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 440 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o szerokości 440 mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości wraz z uchwytem do przetaczania 930 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym wykonanym z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów, odpornej na wysokie temperatury, wilgoć, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne i chemiczne? Jest to rozwiązanie lepsze od płyty meblowej, która jest narażona na odbarwienia pod wpływem wilgoci i wysokich temperatur.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dolną półką do odkładania obuwia nie wyprofilowaną, ale zabezpieczającą przedmioty przed wypadnięciem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z dolną półką do odkładania obuwia nie wyprofilowaną, ale zabezpieczającą przedmioty przed wypadnięciem. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki o szerokości 450 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafki o szerokości 450 mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 7


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki z blatem wykonanym z płyty laminatowej odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV, bez zakończenia tworzywową oblamówką?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki z blatem wykonanym z płyty laminatowej w kolorze białym (bez możliwości wyboru koloru) ? W proponowanych szafkach istnieje możliwość wyboru koloru frontów drzwiczek szuflady i kontenera.

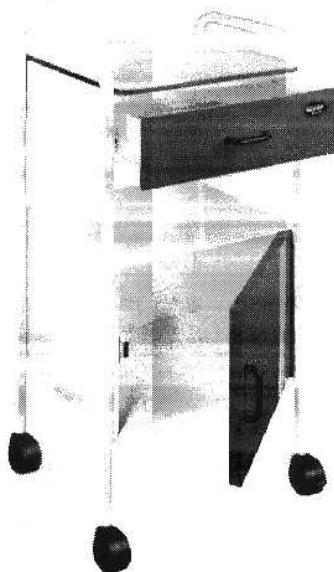

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści szafki z blatem wykonanym z płyty laminatowej w kolorze białym z możliwością wyboru koloru frontów drzwiczek szuflady i kontenera. W pozostałym zakresie wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki z szufladą wysuwaną na prowadnicach rolkowych, bez wyjmowanego wkładu tworzywowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafki z szufladą wysuwaną na prowadnicach rolkowych, bez wyjmowanego wkładu tworzywowego. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki bez półki do odkładania obuwia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki z 4 kołami jezdnyymi wykonanymi z niebrudzącego podłogę tworzywa, 2 koła posiadają blokadę ?

Odpowiedź:

Tak, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 430mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę o szerokości 430mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 800mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę o wysokości 800mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach 86,5 x 51 x 50 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ i wyjaśnieniami.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat główny wykonany jest z laminowanej płyty HPL z możliwością wyboru kolorów, zakończoną aluminiowymi listwami, które zabezpieczają przedmioty przed zsuwaniem się?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową, której blat główny wykonany jest z laminowanej płyty HPL z możliwością wyboru kolorów, zakończoną aluminiowymi listwami, które zabezpieczają przedmioty przed zsuwaniem się.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą na prowadnicach ślizgowych, co stanowi rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez półki na buty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne szafkę przyłóżkową wyposażoną w metalowy uchwyt/reling do powieszenia ręcznika, zamontowany na bocznej ścianie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ z dodatkowym elementem w postaci uchwytu.

Pytania dotyczące: Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – 54 szt.**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krażki odbojowe w narożach łóżka

doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z listwami odbojowymi umieszczonymi na ramie leża na całej jej długości zamiast na barierkach bocznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, wypełnionymi płytą HPL?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowanej, wypełnionymi płytą HPL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowanej, wypełnionymi płytą HPL. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z szczytami wypełnionymi płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji segmentu uda w zakresie 0-37°?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o długości całkowitej równej 2170 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z barierkami bez listew odbojowych? Proponowane łóżka wyposażone są w 4 krążki odbojowe i to one są elementami najbardziej „wystającymi” (nawet przy zamontowanych poręczach bocznych).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka ze szczytami lakierowanymi proszkowo? Pragniemy zauważyć, że Zamawiający w punkcie 3.6 wymaga barierek bocznych lakierowanych proszkowo, dlatego w naszej opinii zasadne jest zastosowanie także lakierowanych szczytów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z możliwością łatwego demontażu szczytu tylko od strony głowy pacjenta? Pragniemy zauważyć, że demontowany szczyt od strony głowy w dużym stopniu ułatwia podjęcie akcji ratunkowych w nagłych wypadkach, natomiast nie ma praktycznego uzasadnienia dla wymogu demontowanego szczytu od strony nóg pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka ze szczytami wypełnionymi wysokiej jakości płytą meblową, laminowaną, wodoodporną, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z wypełnieniem szczytów zamontowanym na stałe? Pragniemy zauważyć, że w proponowanych łóżkach można w łatwy sposób zdemontować cały szczyt od strony głowy pacjenta dlatego nie widzimy konieczności demontowania samego wypełnienia, podczas akcji ratunkowych nie wystarczy demontaż samego wypełnienia – rama szczytu w dalszym ciągu będzie utrudniała dostęp do pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z segmentami leża wypełnionymi metalowymi, lakierowanymi listwami (lamelami) ? Pragniemy zauważyć, że jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego, ponieważ metalowe lamele są łatwiejsze do mycia i dezynfekcji (w metalowych siatkach przy połączeniu prętów powstają miejsca bardzo trudne do mycia i dezynfekcji – co może doprowadzić do gromadzenia się brudu, bakterii i wirusów).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 0-35° ? Pragniemy zauważyć, że wartość ta niewielkim stopniu odbiega od wymaganej, a proponowane łóżka posiadają także elektryczną regulację pozycji Trendelenburga i anti-Trendelenburga.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z pilotem przewodowym z możliwością jednoczesnej blokady wszystkich funkcji elektrycznych łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z segmentem oparcia pleców bez funkcji autoregresji? Proponowane łóżka posiadają elektryczną funkcję autokontur (jednoczesny ruch oparcia pleców i segmentu uda), która zabezpiecza pacjenta przed zakleszczeniem się oraz zsuwaniu jego nóg w kierunku szczytu nóg.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z 4 kołami nieantystatycznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z 4 kołami z indywidualną blokadą, bez funkcji jazdy na wprost?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z 4 kołami o średnicy 100 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z pokrowcami materacy, które zamiast opinii laboratoryjnej potwierdzającej właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot posiadają certyfikat o nieprzenikaniu roztoczy oraz właściwościach antibakteryjnych wydany przez producenta tkaniny, z której produkowane są pokrowce do proponowanych materacy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z ramą w kolorze popielatym?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżka z ramą w kolorze popielatym. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami bocznymi bez listew odbojowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 415mm-815mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (54 szt.) z tulejami do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki znajdującymi się w dwóch narożnikach łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – 54 szt o wymiarach zewnętrznych: całkowita długość 2160mm x całkowita szerokość 970 mm o wymiarach leża 850 mm x 2000mm

Parametry tylko nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na komfort i bezpieczeństwo podczas eksploatacji

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne sterowane elektrycznie o wymiarach zewnętrznych: całkowita długość 2160mm x całkowita szerokość 970 mm o wymiarach leża 850 mm x 2000 mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – 54szt ze szczytami łatwo demontowalnymi bez możliwości łatwego demontażu wypełnień szczytów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w demontowane szczyty tworzywowe zapewniające wyższy poziom dezynfekcji oraz większą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2140mm? Parametr różni się zaledwie o 10mm od dopuszczonej tolerancji i nie wpływa na użytkowanie łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko o długości 2140mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego całkowita szerokość wraz z barierkami wynosi 1060mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego szerokość leża wynosi 860mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne, którego szerokość leża wynosi 860mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 31

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta dopuści łóżko szpitalne, wyposażone w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża za pomocą dwóch przycisków? Rozwiązanie wyklucza możliwość przypadkowego zwolnienia blokady barierki, zwolnienie zawsze następuje w sposób świadomy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści tuleje do mocowania wysięgników i stojaka kroplówki w dwóch narożnikach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji maksymalnie do 405-810 mm, co stanowi parametr nieznacznie różniący się od opisanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko o regulacji maksymalnie do 405-810 mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, które nie jest wyposażone w funkcje autoregresji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, wyposażone w antystatyczne koła, których rdzeń osłonięty jest osłoną tworzywową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne, wyposażone w antystatyczne koła, których rdzeń osłonięty jest osłoną tworzywową. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego bezpieczne obciążenie robocze wynosi 170kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą dostępną w kolorze białym, powszechnie stosowanym w szpitalach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta wymaga aby łóżko posiadało akumulator pozwalający na obsługę łóżka niepodłączonego do prądu? Wyposażenie łóżka w akumulator zapewnia ciągłość pracy oraz możliwość wykonywania regulacji elektrycznych w trakcie transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka posiadającego akumulator pozwalający na obsługę łóżka niepodłączonego do prądu. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w szczyty z możliwością wyboru koloru wypełnień z palety min. 10 kolorów, w tym kolor żółty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w szczyty z możliwością wyboru koloru wypełnień z palety min. 10 kolorów, w tym kolor żółty. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne wyposażone w materac pneumatyczny (opisany w pkt 15 zestawienia) z komorami poprzeczno-wzdłużnymi? Zastosowanie komór poprzeczno-wzdłużnych jest efektywniejszą metodą terapii przeciwoleżynowej, z uwagi na skuteczniejszy rozkład ciężaru ciała pacjenta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko i materac pneumatyczny pochodziły od jednego producenta w celu idealnego dostosowania materac do wymiarów leża oraz zapewnienia pełnej kompatybilności materaca z łóżkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby łóżko i materac pneumatyczny pochodziły od jednego producenta.

Szafka przyłóżkowa z regulowanym białem bocznym – 54 sztuki.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych i blachy pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV ? Profile aluminiowe to parametr czysto marketingowy, mający na celu ograniczanie konkurencji na poziomie parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych lakierowanych na kolor aluminium ? Profile aluminiowe to parametr czysto marketingowy, mający na celu ograniczanie konkurencji na poziomie parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami wysuwanymi na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z jedną szufladą wysuwaną dwustronnie oraz szafką zamykaną drzwiczkami, otwieraną dwustronnie, z miejscem na 3 butelki 1,5 l wewnątrz zamykanej szafki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem głównym i bocznym wykonanym z płyty z tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z czołami szuflad wykonanych z blachy lakierowanej proszkowo na dowolny kolor?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową otwieraną dwustronnie, bez konieczności przekładania blatu bocznego? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 800 – 1100 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłózkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 800 – 1100 mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o wysokości 910 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o wysokości 910 mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o szerokości 520 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o wymiarach blatu bocznego 660 x 430 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłózkowe z blatem bocznym opisane jak poniżej?

Szafka wykonana z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej pokrytych lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002. Blaty szafki (główny i boczny) wykonane z trwałego tworzywa ABS. Czoła szuflad oraz drzwiczek wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym (możliwość wyboru koloru – dostosowanie do koloru wypełnień szczytów łóżek). Dwoje drzwiczek i zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne szuflady, pozwalające w prosty sposób ustawić żądany kierunek jej wysuwu, umożliwią dostawienie szafki z prawej lub z lewej strony łóżka. Szuflada posiada dwukomorowy tworzywowy wkład, a w skrzynce szafki zamykanej drzwiczkami znajduje się półka. Kółka jezdne umożliwiają przemieszczanie szafki, a dwa z nich posiadają blokadę. Szafka posiada blat boczny zamocowany na stałe, z regulacją: wysokości i kąta nachylenia. Blat boczny jest składany do boku szafki, prosty sposób unoszenia i rozkładania. Konstrukcja szafki trwała, stabilna, odporna na środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w szpitalach.



DANE TECHNICZNE

- Długość x szerokość: 510 x 390 mm
- Wysokość blatu stałego: 860 mm
- Regulacja wysokości blatu bocznego: 760 do 1060 mm
- Przechył blatu: $\pm 30^\circ$

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ i nwyjaśnieniami.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłódkową wykonaną z profili stalowych oraz blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w jedną szufladę, otwartą półkę, kontener zamykany drzwiczkami oraz blat boczny i blat górny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 550x340mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę z blatem bocznym o wymiarach 550x340mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 730-1000mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronna z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladami wysuwanymi na prowadnicach kulkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe (54 szt.) z szufladami wysuwanymi na prowadnicach rolkowych bez mechanizmu samodomykającego się?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafki przyłóżkowe (54 szt.) z szufladami wysuwanymi na prowadnicach rolkowych bez mechanizmu samodomykającego się. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji stalowej, ocynkowanej zapewniającej dużą trwałość konstrukcji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w górną szufladę i dolną komorę szafki, których fronty wykonane są z dwustronnie laminowanej płyty HPL?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną bez potrzeby przekładania blatu w celu postawienia po dwóch stronach łóżka? Rozwiązanie korzystniejsze od opisanego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach: wysokości 86,5 cm, szerokości 51,5 cm i głębokości 50 cm i rozmiarem blatu 60x34,5 cm? Wymiary tylko nieznacznie odbiegają od opisanych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę o wymiarach: wysokości 86,5 cm, szerokości 51,5 cm i głębokości 50 cm i rozmiarem blatu 60x34,5 cm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 24

Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat boczny z regulacją wysokości w zakresie 720 – 1080mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat boczny z regulacją wysokości w zakresie 720 – 1080mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści szafkę z kołami o rozmiarze 75 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza szafkę z kołami o rozmiarze 75 mm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści szafkę z możliwością wyboru kolorów frontów dostosowaną do wypełnień w łóżku, w tym z odcieniem żółtego i konstrukcją w kolorze białym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą na prowadnicach ślizgowych, co stanowi rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytania do treści SIWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji w tym przetargu do 42 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin realizacji zamówienia (Pakiet nr 1) do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie terminu realizacji Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w §5 ust. 1 projektu umowy z 1% do 0,2% wartości netto nie dostarczonej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści rozbić pakietu nr 1- łóżka szpitalne wraz z szafkami na mniejsze pakiety dotyczące konkretnego typu łóżek z wyposażeniem?

Rozbić tego pakietu na mniejsze elementy pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert, przez co Zamawiający uzyska szerszy obraz dotyczący dostępnych rozwiązań od większe liczby producentów i firm handlowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ .

Pytanie 6

Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert i co za tym idzie obniżenie cen zakupu wymaganego sprzętu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy? W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowany termin, prosimy o określenie, o ile Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy pkt. IV.1 b Specyfikacji Istotnych Warunków

W pkt. IV.1 b Zamawiający określił Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, który zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, dostawy głównej na kwotę co najmniej 250 000 zł, rozumianej jako dostawę **łóżek szpitalnych**.

Prosimy o rozszerzenie specyfikacji asortymentu dostawy głównej, niezbędnej do uznania spełnienia tego warunku i dopuszczenie wykonawców, którzy wykazują się wykonaniem, w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, dostawy **sprzętu medycznego** na kwotę co najmniej 250 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

z up. Zarędk
p.o. DYREKTOR
DS. ADMINISTRACYJNYCH
Ela Kwaśnicka
mgr Ela Kwaśnicka

